

2023年7月吉日

お得意先各位

カイ インダストリーズ株式会社  
医療器事業本部 国内営業部

## 生検トレパン・皮膚キュレット 封緘シール変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、皮膚科製品「生検トレパン」[皮膚キュレット]について、封緘シールを変更させていただくことになり、下記の通りご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### ■対象製品

生検トレパン（レギュラータイプ、ロングタイプ、プランジャー付タイプ）  
皮膚キュレット

### ■変更内容

封緘シールの変更

※ 詳細は、別紙をご参照願います。

### ■切替時期

2023年8月生産ロットより

※ 現行仕様の在庫が無くなり次第順次切替となりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点やご質問などがございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。

以上

＜お問い合わせ先＞

カイ インダストリーズ株式会社


医療器事業本部 国内営業部

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110

TEL: 0575-28-6600 / FAX: 0575-28-6611


E-mail: medical-ja@kai-group.com

＜生検トレパン 封緘シール変更イメージ＞

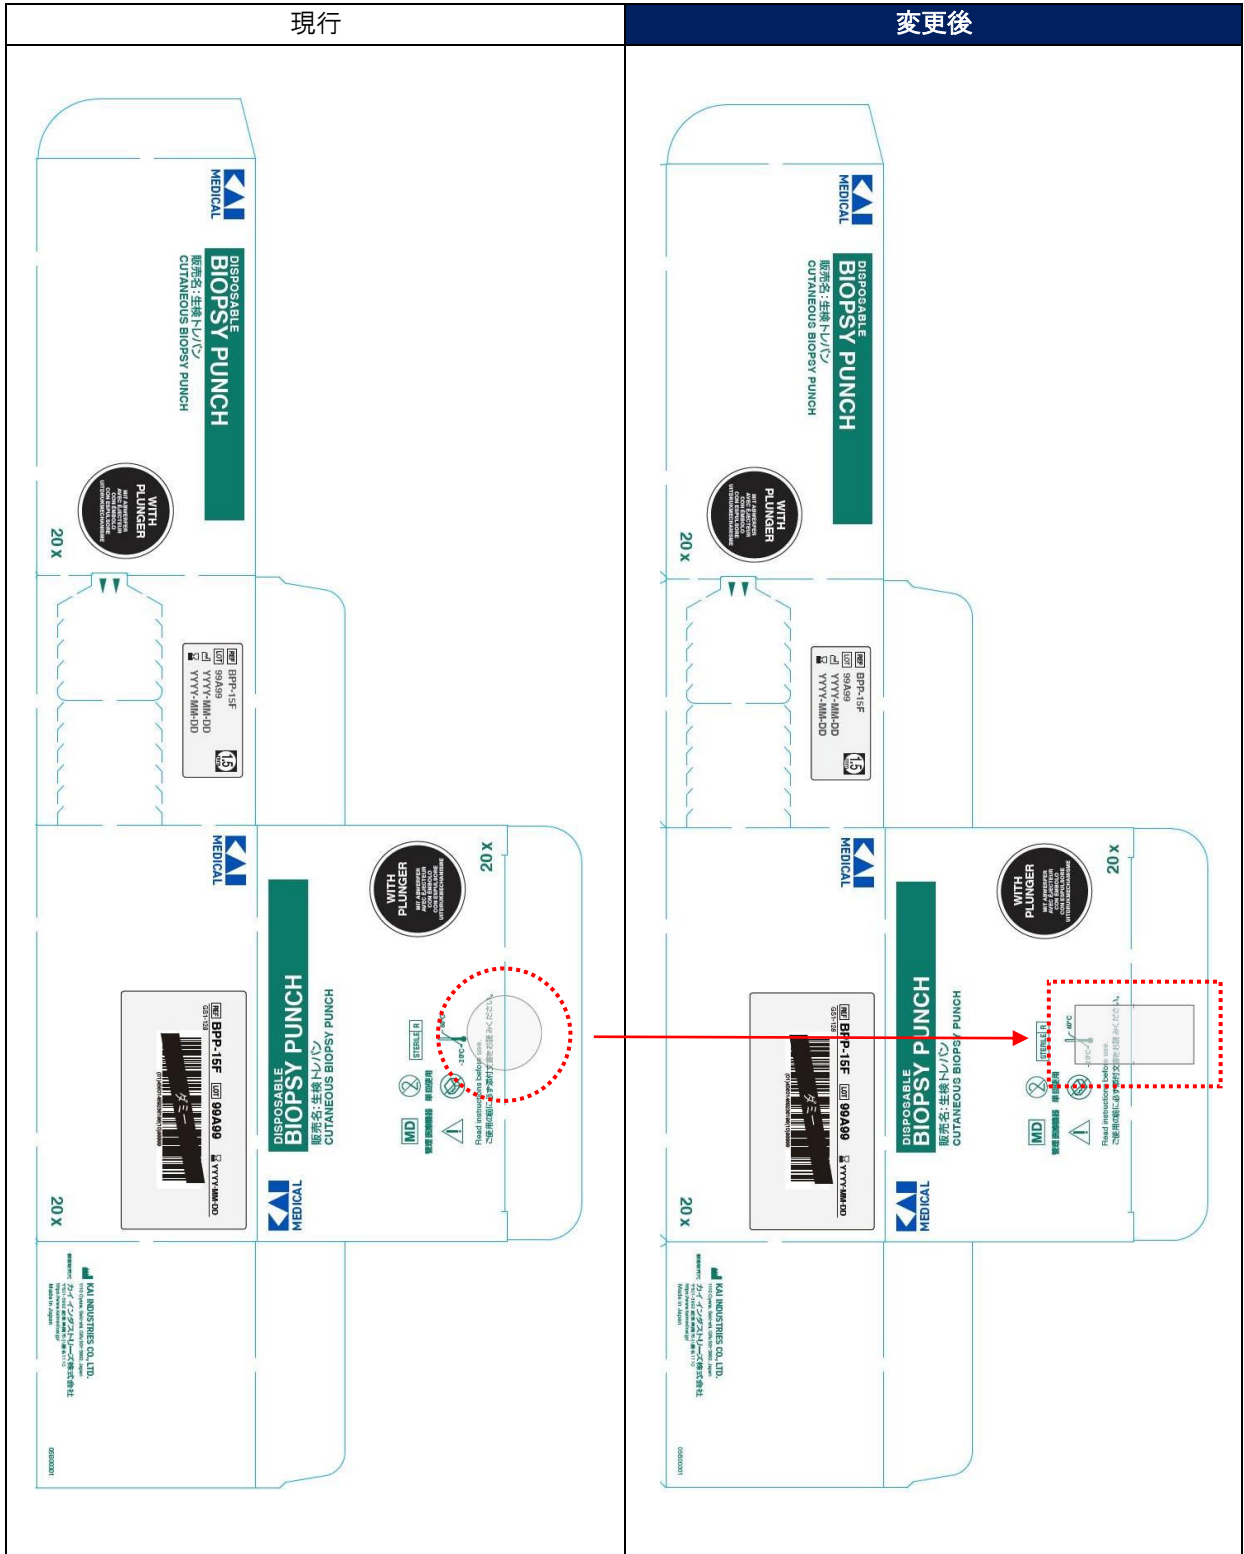

\*Lot 番号、製造日、滅菌期限はダミー印字です

＜皮膚キュレット 封緘シール変更イメージ＞

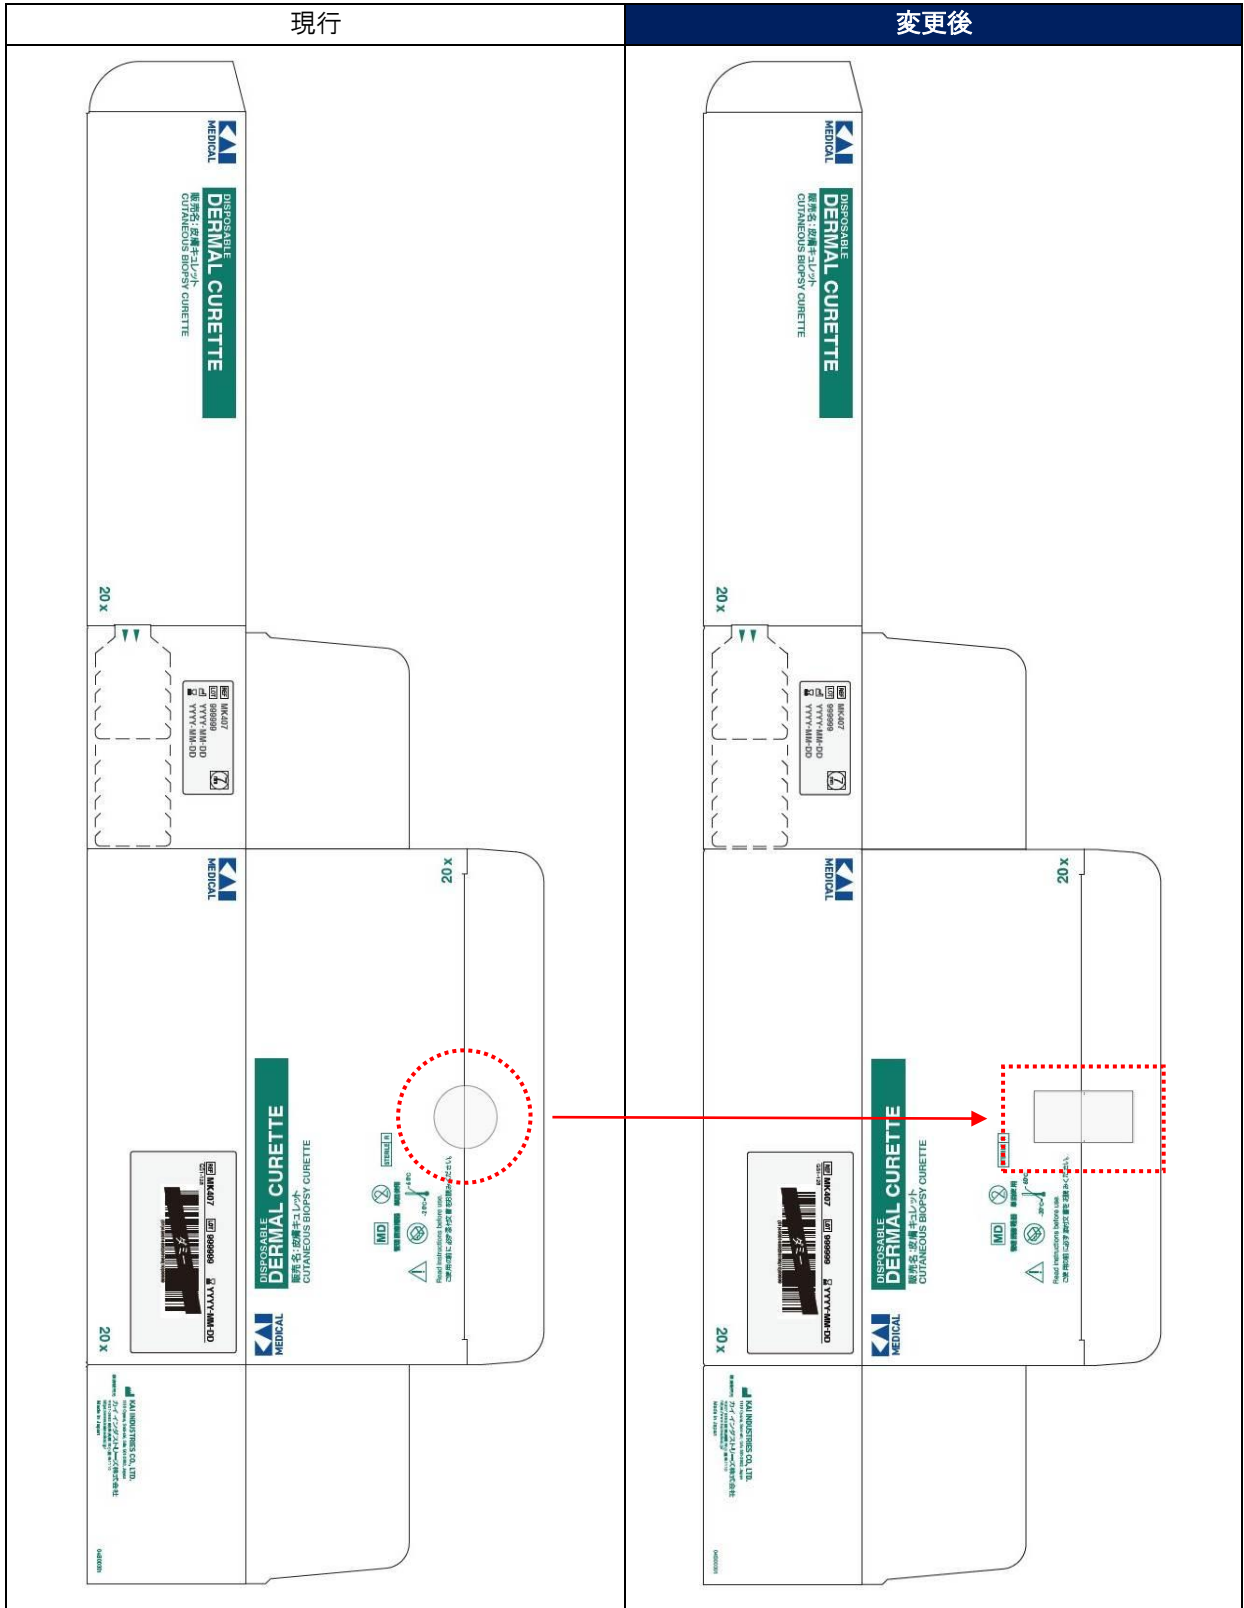

\*Lot 番号、製造日、滅菌期限はダミー印字です