



お得意先各位

2025年8月吉日

カイインダストリーズ(株)
医療器事業本部 国内営業部

マイクロナイフ仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の滅菌方法、JANコード、パッケージデザインを変更させていただくこととなりましたので、ご案内いたします。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象製品

- ・販売名：マイクロナイフ
- ・製品名：涙嚢切開ナイフ
- ・品番：DCR-15

■変更内容

- ・滅菌方法変更：EOG滅菌 ⇒ (変更後) **γ線滅菌**
- ・JANコード変更：4560146928256 ⇒ (変更後) **4562143741500**
- ・パッケージデザイン変更：別紙参照

■変更時期

2025年11月以降の生産分より
(現行品の在庫がなくなり次第、仕様変更品の出荷に切り替わります。)

詳細は、弊社WEBサイトからご確認いただけます。

<https://www.kaimedical.jp/news>

ご不明な点やご質問などがございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。

以上


〈お問い合わせ先〉

カイインダストリーズ株式会社
医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
TEL：0575-28-6600 / FAX：0575-28-6611
E-mail：medical-ja@kai-group.com


マイクロナイフ仕様変更のご案内（別紙）

包装小箱

変更後パッケージデザイン

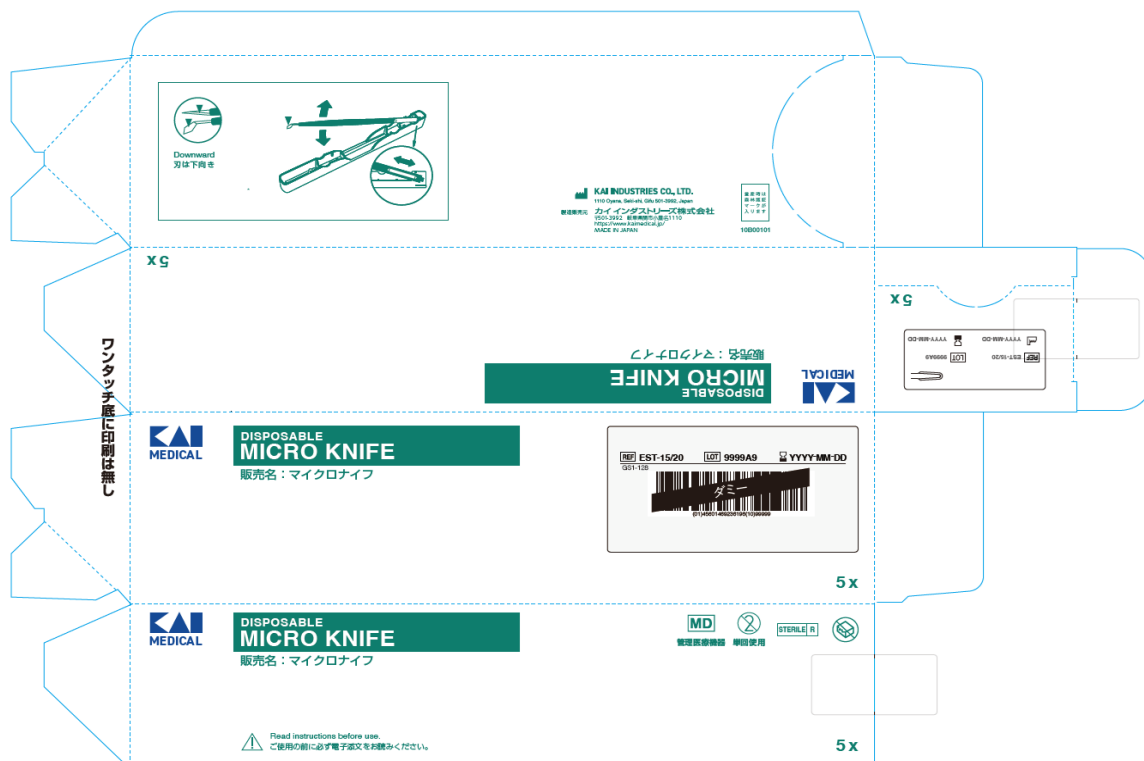

滅菌袋

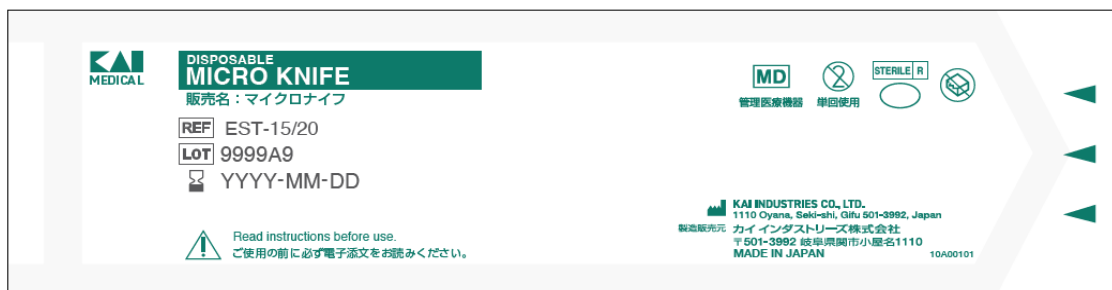

<お問い合わせ先>
 カイインダストリーズ株式会社
 医療器事業本部 国内営業部
 〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
 TEL：0575-28-6600 / FAX：0575-28-6611
 E-mail：medical-ja@kai-group.com